

## Die Licht-Akupunktur mit dem Regulus-Medi-Light-Pen

Das **Bio-Physio-Verfahren** (nach Klaus Eikenberg) mit dem PEN überträgt - anders als bei einer Akupunkturnadel - die mit dem „Goldenen Schnitt“ codierte Energie als Biophotonen-Lichtimpuls auf den gewählten Akupunkturpunkt. Wählen Sie also aus der auf der Innenseite befindlichen Akupunkturtafel das entsprechende Organ und drücken Sie die LED-Spitze direkt für 1-3 Minuten auf diesen Punkt.

## Energetisierung des Körpers durch den Regulus-Medi-Light-Pen -

### Aktivierung der Selbstregulierung

Das gesamte Körpersystem incl. des Haltungsapparates wird durch die Aktivierung der Selbstregulation neu ausgerichtet. Der PEN aktiviert die Selbstregulierungskräfte des Körpers - auch bei Körperfehlstellungen. Die vom PEN erzeugten Biophotonen reduzieren und reinigen vom Körper aufgenommene negative elektromagnetische Strahlungen.

Empfohlen wird eine E-Smog-Reinigung gerade auch bei Kindern in der Wachstumsphase - vor dem Schlafengehen jeweils 1 bis 3 Minuten

### Wichtige Information:

Bezüglich der Wirkungsweise dieses Systems wird keinerlei Heilversprechen oder Heilerfolgsaussicht gegeben. Hersteller, Verkäufer und Betreiber haften nicht für evtl. Körper- oder Geistesschäden und jedwede zufällige, spezifische oder indirekte Folgeschäden.

## Energetisierung von Lebensmitteln & Getränken

Durch die **Biophotonenbestrahlung** von Lebensmitteln und Getränken mit dem PEN wird die verwertbare Energie durch Anregung der Molekularstruktur in den Lebensmitteln und Getränken deutlich erhöht.

### Das Farbspektrum der LED

Beim Farbspektrum der LED handelt es sich um eine Wellenlänge von 575 nm-580 nm. Sie wirkt, neben der auf dem Chip codierten Übertragung der Aktivierung der Selbstregulation, harmonisierend und ausgleichend. Sie wird in der Medizin häufig für den Pupillenreflex-test eingesetzt. Das Farbspektrum der LED enthält keinen Blau-Lichtanteil.



### Das Auswechseln der Batterien bei Ihrem Regulus-Medi-Light-Pen

Schrauben Sie die obere Kappe des Regulus-Medi-Light-Pen auf und legen Sie die 2 Batterien (AAA) mit dem +Pol in Richtung LED.

### Kontakt:

Klaus Eikenberg  
Hellweg 2 - 59423 Unna  
Tel.: 0 23 03 - 27 77 34  
eMail: ruecken-therapie@t-online.de  
Inhalt: Klaus Eikenberg  
Druck: DIMM (dimm-mittelhessen.de)  
Layout: t3marketeers Ralf Klos



bio  
physio

Gesunde Zukunft jetzt

# Bedienung & Anwendung


Zum Einschalten der LED drücken Sie einfach auf den Einschaltknopf am oberen Ende des PEN - ebenso zum Ausschalten.

- Halten Sie kurz (Max. 1 Sek.) den eingeschalteten PEN auf die geschlossenen Augen mit einem Abstand von ca. 1 cm
- Halten Sie die Augen geschlossen und richten nun den Lichtstrahl auf den Punkt oberhalb der Nasenwurzel und der Stirnmitte. Dieses Areal ist wie eine lichtdurchlässige Brücke zum Gehirn bzw. der Zirbeldrüse
- Richten Sie nun den Lichtstrahl abwechselnd zuerst auf das rechte Innenohr und nach 10 Sek. auf das linke Innenohr. Die Anwendungsdauer richtet sich hier ganz nach Ihrem persönlichen Empfinden.

Nun ist Ihre körpereigene Selbstregulation aktiviert. Anschließend können Sie wahlweise den Nacken, die Schilddrüse, Verspannungen oder schmerzende Stellen gezielt behandeln.

Die Behandlungsdauer dieser Bereiche sollte mind. 1 Minute bis max. 3 Minuten betragen.

**Regulus-Medi-Light-PEN ist eine Produktentwicklung der Bio Physio Klaus Eikenberg. Die wissenschaftliche Mitarbeit erfolgte durch Prof. Dr. Dr. Enrico Edinger**

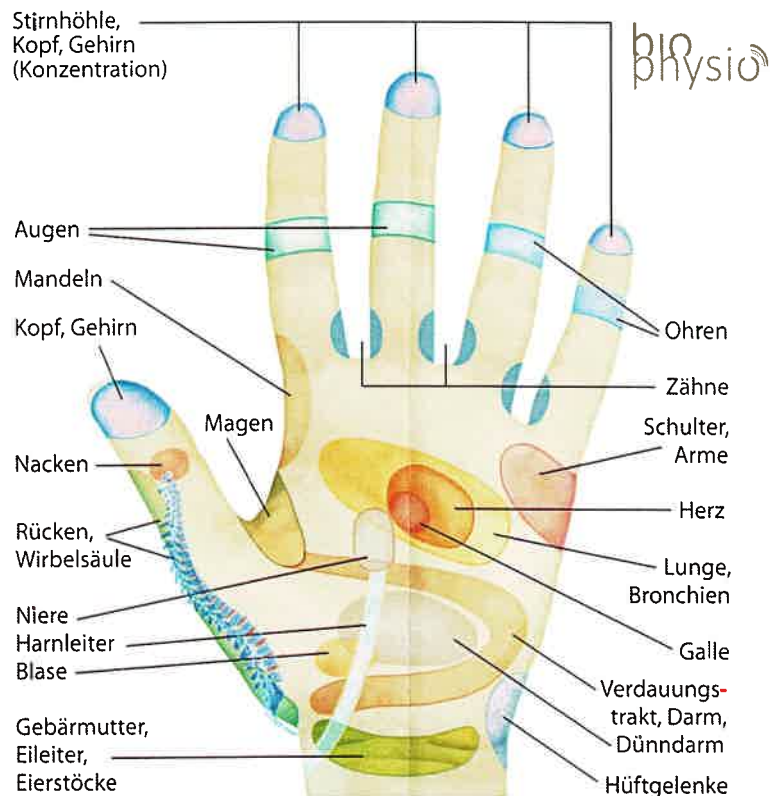

Sie können sich ebenso an den Handakupunkturpunkten der koreanischen Handakupunktur orientieren, wie sie hier aufgezeichnet sind. Die unterschiedlichen Areale repräsentieren das dazu beschriebene Organ.



Bitte schauen Sie nicht mit offenen Augen in die LED! Das Bio-

Physio-Verfahren ist entwickelt aus der empirischen Medical Wellness. Die Anwendung ersetzt nicht den evtl. notwendigen Besuch eines Arztes oder Therapeuten.

