

medical equipment Dorfstr. 12 76571 Gaggenau

02.08.2018

JSR GmbH
Harzblick 15

38173 Veltheim

Messprotokoll für den Deckenionisator Hersteller JSR GmbH Veltheim


Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben am 02.08.2018 bei Ihrem Deckenionisator eine Ionenmessung vorgenommen.

Der Ionisator arbeitet mit 7 x rostfreien Ionisationsnadeln, die mit einer ca. 4,23KV negativen Spannung aufgeladen sind.

Das Gerät kann an eine Sauerstoffquelle angeschlossen werden.

Die Messung mit dem IONOMETER IM 5001 hat bei einer Sauerstoffdurchströmung Von 9 Litern/min. eine **Ionenkonzentration von 5×10^6 Ionen/cm³ gezeigt.**

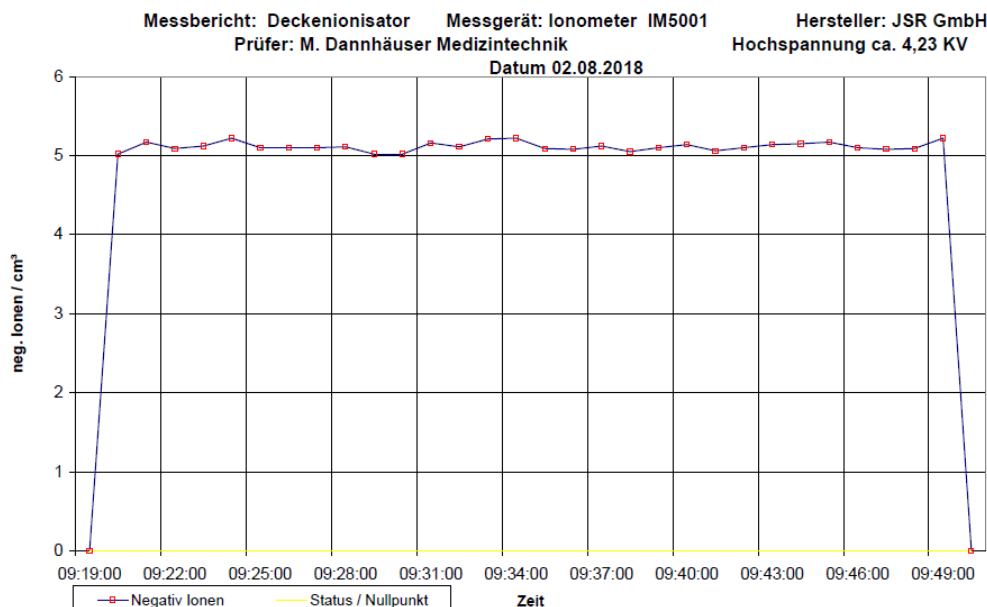

Mit freundlichen Grüßen


Michael Dannhäuser